

2024年3月

お客様 各位

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

尿検査試験紙ボトルラベル及び化粧箱デザイン変更のご案内

謹啓

2023年9月発刊の「HCD23-189 尿検査試験紙ボトルラベル及び化粧箱デザイン変更のご案内」の通り、「N-マルティスティックス SG-L」をはじめとする尿検査試験紙におきまして、ボトルラベル及び化粧箱デザインが変更となります。新デザインの製品は順次出荷されておりますので、初回出荷ロット、初回出荷日情報を下記の通りご案内申し上げます。

【変更点】

- ・ボトルラベル及び化粧箱デザインが白ベースのものに変更となります。
- ・2021年8月に施行されました医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、本デザイン変更品より、添付文書の同梱を終了しました。
なお、この変更による比色ブロックの仕様・製品性能の変更は一切ございません。

【対象製品】

品名	包装	貯法	統一商品コード	品目コード	シーメンスコード	初回出荷ロット	初回出荷日
N-マルティステックス SG-L 体外診断用医薬品	100 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559823006	2300	10334105	308006	2023/09/05
マルティステックス PRO 10LS 体外診断用医薬品	100 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559815612	1561	10340629	308014	2023/10/04
クリニテック ミクロアルプ・ クレアチニンテスト 体外診断用医薬品	25 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559820890	2089	10332631	308017	2023/10/10
ライフステックス 体外診断用医薬品	100 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559823068	2306	10334925	308010	2023/10/17
マルティステックス SG-L 体外診断用医薬品	100 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559823167	2316	10334765	308056	2023/12/5
ウロラブステックス SG-L 体外診断用医薬品	100 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559823211	2321	10340836	308011	2023/11/16
ウロヘマコンビステックス SG-L 体外診断用医薬品	100 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559823235	2323	10338139	308019	2023/10/05
ネフロステックス-L 体外診断用医薬品	100 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559823266	2326	10336865	308088	2023/12/20
マルティステックス SG 体外診断用医薬品	100 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559827417	2741	10332603	308016	2023/09/26
ラブステックス 体外診断用医薬品	100 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559828100	2810	10334566	308012	2023/11/6
ウロラブステックス 体外診断用医薬品	100 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559828131	2813	10339212	308004	2023/10/16
マルティステックス 体外診断用医薬品	100 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559828209	2820	10339189	308013	2023/10/30
ヘマステックス 体外診断用医薬品	100 枚	30°C以下 冷蔵庫不可	559828278	2827	10336480	308026	2023/11/8


品名	包装	貯法	統一商品コード	品目コード	シーメンスコード	初回出荷ロット	初回出荷日
ウリステイクス	100 枚	30℃以下 冷蔵庫不可	559828551	2825	10334746	308021	2023/10/05
体外診断用医薬品							
アルブステイクス	100 枚	30℃以下 冷蔵庫不可	559828704	2870	10334519	308028	2023/10/23
体外診断用医薬品							
ヘマコンビステイクス	100 枚	30℃以下 冷蔵庫不可	559828766	2876	10336654	308020	2023/10/04
体外診断用医薬品							
ウロヘマコンビステイクス	100 枚	30℃以下 冷蔵庫不可	559828780	2878	10336613	308018	2023/10/19
体外診断用医薬品							
マルティステイクス PRO 11	100 枚	30℃以下 冷蔵庫不可	559815643	1564	10340625	309050	2024/3/13 見込み
体外診断用医薬品							
マイクロアルブミン 9	25 枚	30℃以下 冷蔵庫不可	559616011	2093	10285742	308003	2023/11/01
体外診断用医薬品							
ケステイクス 100	100 枚	30℃以下 冷蔵庫不可	559828810	2881	10917960	308027	2023/10/10
体外診断用医薬品							
ダイアステイクス 100	100 枚	30℃以下 冷蔵庫不可	559828032	2803	10917958	308067	2023/12/11
体外診断用医薬品							
ケトダイアステイクス 100	100 枚	30℃以下 冷蔵庫不可	559828827	2882	10917961	308029	2023/11/21
体外診断用医薬品							

*2024年3月時点での情報です

ボトルラベル（以下の写真はN-マルティスティックス SG-Lを例にしたものです）



化粧箱

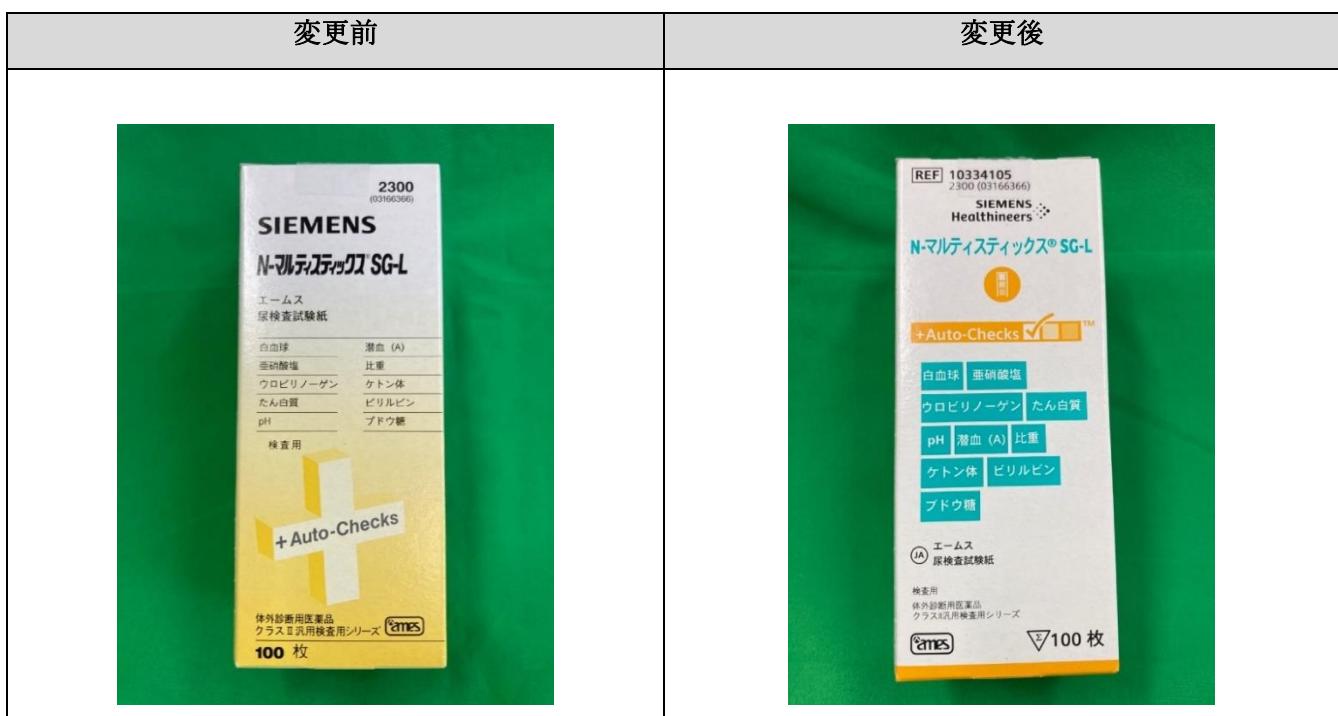





【本件に関するお問い合わせ先】

カスタマーケアセンター 電話番号:03-4582-5520 平日(月～金)8:30～18:30

クリニテック ミクロアルブ・クレアチニンテスト

承認番号:21100AMY00025000

上記以外のエームス尿検査試験紙

承認番号:16100AMZ03365000